


عنوان فرآیند: صدور گواهینامه کالیبراسیون

مدارک مرجع / توضیحات

شرح کار

مدارک خروجی یا سوابق ایجاد شده

در صورت بروز صدمات به ابزار، مشکوک بودن نتایج اندازه گیری، یا رد شدن ابزار در کنترل ها، ممکن است مابین کالیبراسیون ها، کالیبراسیون مجدد نیز لازم باشد.

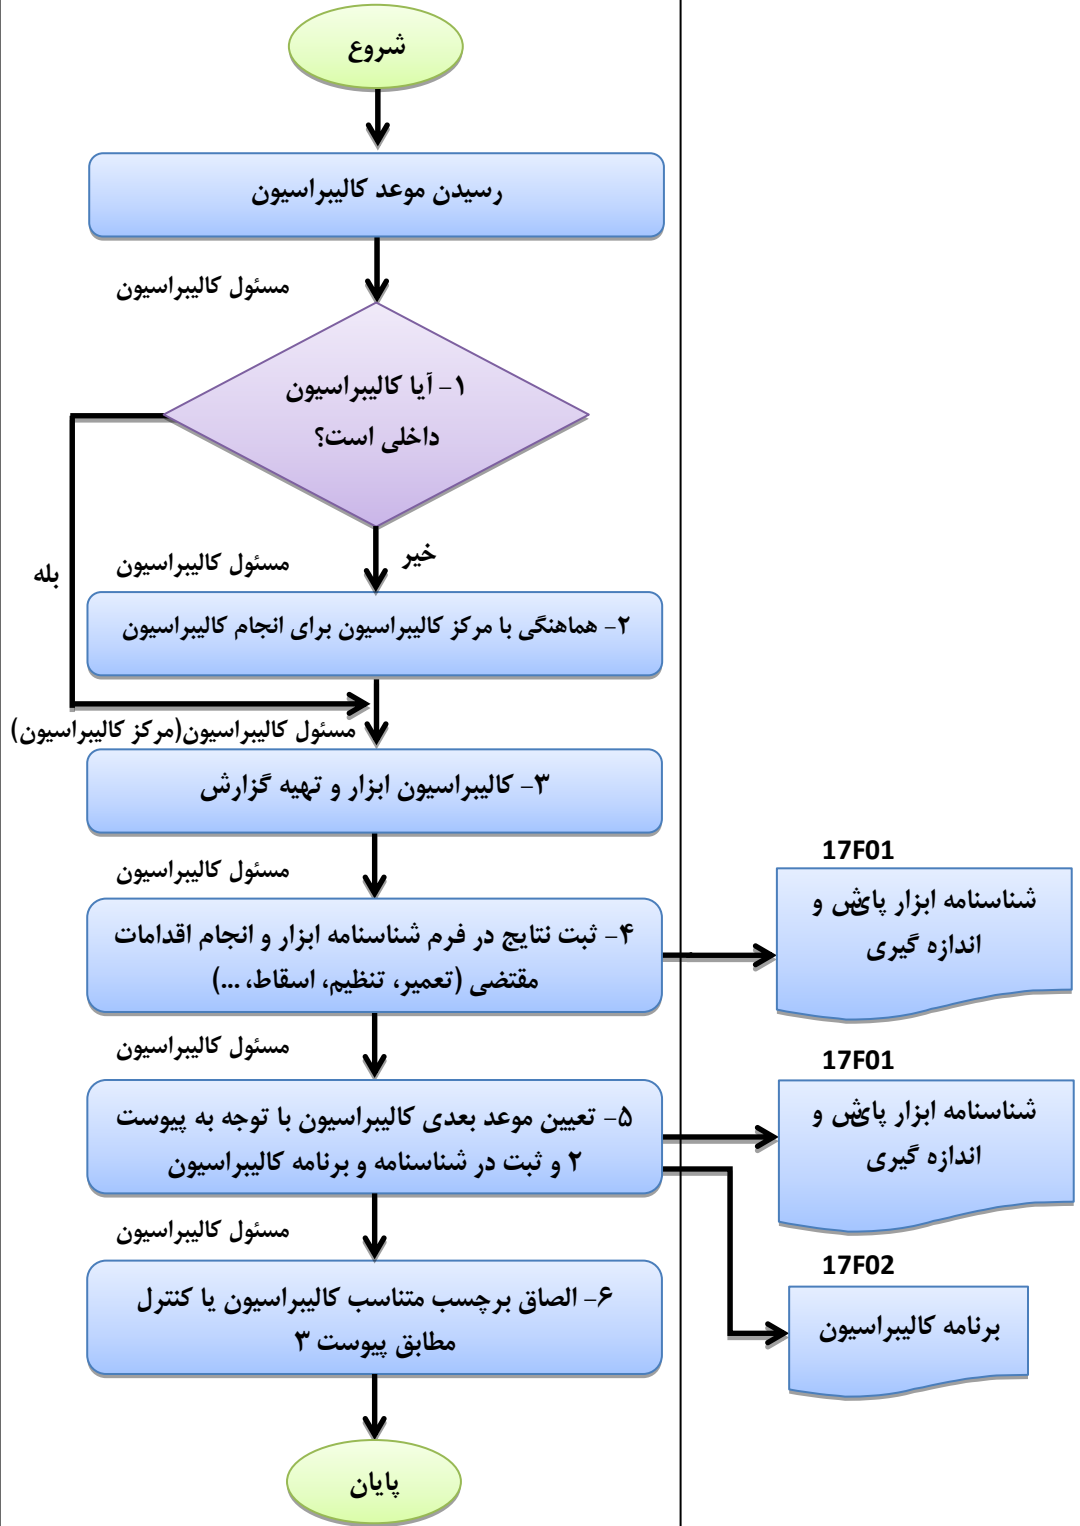

۳- در گزارش های کالیبراسیون اعم از داخلی یا خارجی نتایج اندازه گیری ها لازم است ثبت شده باشد.